

Evaluación de satisfacción con dispositivo autotoma vaginal para detección VPH vs toma por profesional en cribado cáncer



Laura Pardo Matallín, Raquel Escudero Rivas, Lola de Jaime Mahedero, Alba Martínez Gough, Rodrigo López Castro, Javier Luis López Hidalgo. Hospital Universitario Clínico San Cecilio (Granada).

OBJETIVO

Evaluar la aceptabilidad del nuevo dispositivo **Self Deltaswab para autotoma vaginal (Deltalab S.L.)** frente a toma de muestra VPH en medio líquido realizada por personal sanitario en mujeres atendidas en consulta de patología cervical.

MÉTODOS

- Estudio prospectivo. **106 mujeres (28-65 años)** atendidas en consulta de Ginecología del HUSC (Granada).
- Realización de **autotoma vaginal** en consulta y **muestra VPH** por un facultativo → 106 muestras pareadas.
- Autotoma conservada en vial seco a Tª ambiente hasta su procesamiento.
- Análisis con ensayo HPV 360 (Vitro S.A.) → 14 genotipos VPH HR.
- Cuestionario anónimo de satisfacción valorados en **escala Likert de 4 puntos** (1=totalmente en desacuerdo; 4=totalmente de acuerdo): claridad de instrucciones, facilidad de inserción y retirada de dispositivo, molestias y preferencia respecto a la toma profesional y lugar de la autotoma.


CONCLUSIONES

El nuevo dispositivo Self Deltaswab para autotoma vaginal es **fiable** para detección VPH, **fácil y cómodo** de usar. Presenta **muy buena aceptación** por las pacientes. La ausencia de molestias y la preferencia de realización en domicilio **apoyan su implementación en programas de cribado poblacional de cáncer cérvix** mediante detección VPH (ADN), reduciendo la sobrecarga asistencial e incrementando la cobertura, especialmente en población desfavorecida y zonas con menos recursos.

RESULTADOS

89% concordancia VPH positivo.
Kappa 0,75 (IC95% 0,616-0,883).

104 pacientes respondieron cuestionario (escala Likert).

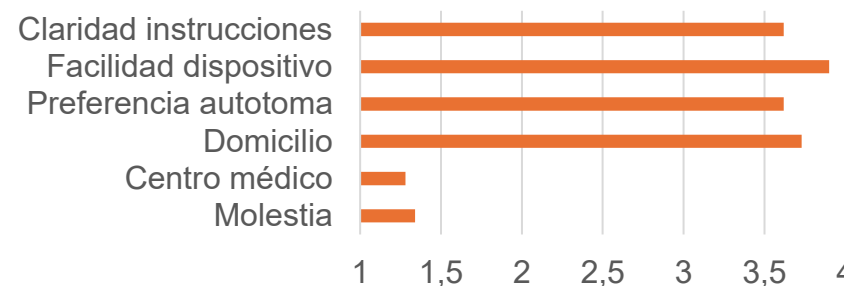

Preferencias según rango etario.

